

Respireo Soft Nasal Silent



Famille de dispositif Masques

Type de dispositif Masque nasal à fuite

Centre(s) d'évaluation Laboratoire de Physiologie de Nancy (Bruno Demoulin)
 ASTEN Santé / DDS Assistance (Aurélien Guillaume)

Date des essais Juin 2019


Fabricant Air Liquide Medical System
Distributeur Air Liquide Medical System

Caractéristiques générales (valeurs mesurées par le Laboratoire de Physiologie de Nancy)

Poids du masque (g) 55

Poids du harnais (g) 25

Particularités Fuite intentionnelle diffuse en polymère micro-percée placée près de la rotule articulée.

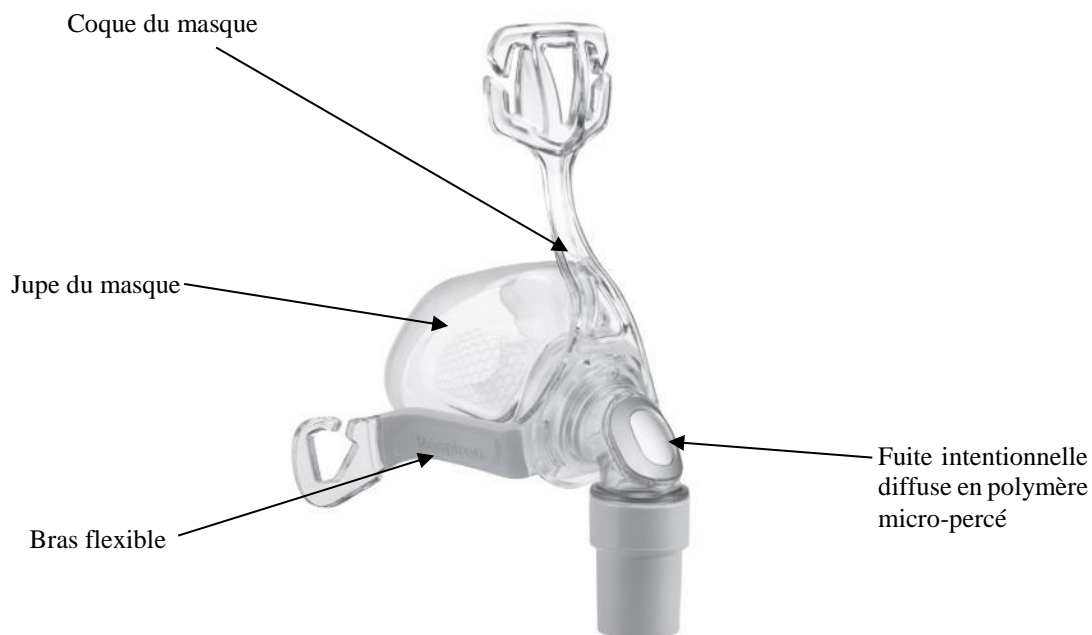

Références :

Masque Respireo Soft Nasal Silent tailles S/M 472365
 Masque Respireo Soft Nasal Silent taille L 472366


Contrôle du débit de fuite du masque par rapport à une fuite standard de 4 mm (mesures réalisées par le Laboratoire de Physiologie)

Rappel du protocole (version du 02/11/2004)

Accessoires : fuite de 4 mm de diamètre.
 Principes : La courbe pression/débit des masques neufs étudiés est comparée à une courbe pression/débit de référence réalisée en utilisant une fuite non linéaire caractérisée par un orifice de 4 mm de diamètre (débit de fuite suffisant pour garantir un rinçage du CO₂ satisfaisant). Tous les tracés, après avoir été reproduits au moins deux fois, seront datés et associés à la courbe de référence du jour des essais. Toute courbe superposable ou située à droite de la courbe de référence (pour une pression donnée, le débit de fuite du masque étudié est supérieur ou égal au débit de l'orifice de 4 mm) signifie que le masque évalué se classe « dans la norme », toute courbe située à gauche de la courbe de référence signifie que le masque se classe « hors norme » ou « à utiliser avec certaines précautions (à préciser) ».

Résultats

Fuite du masque Respireo Soft Nasal Silent par rapport à une fuite de 4

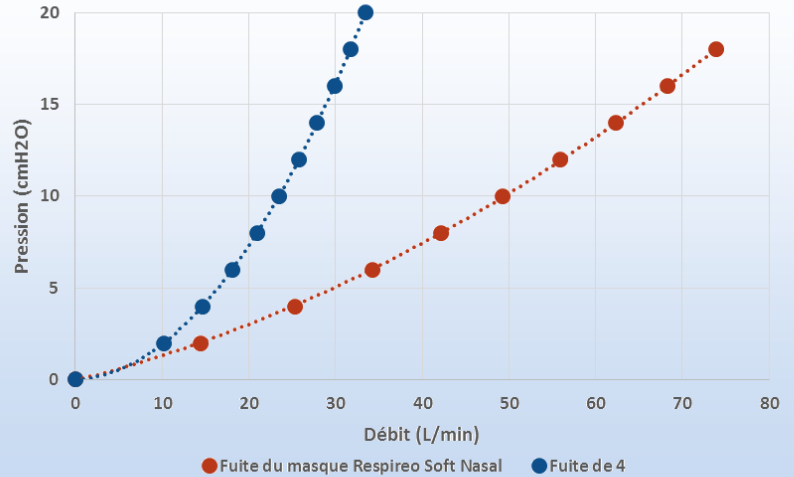

Les masques neufs testés assurent un rinçage supérieur à la fuite de 4mm.


Evaluation du masque par les patients (étude réalisée par ASTEN Santé / DDS Assistance)

Rappel du protocole

Les évaluations sont réalisées après 8 et 30 jours d'utilisation à domicile du masque à tester par un échantillon de 10 patients répartis en 3 groupes.

- Groupe 1 : 4 nouveaux patients à l'occasion de leur premier appareillage
 - Groupe 2 : 3 patients satisfaits de leur masque actuel et volontaires pour tester un nouveau masque
 - Groupe 3 : 3 patients rencontrant des difficultés avec leur masque actuel et volontaires pour tester un nouveau masque
- 10 critères étudiés relatifs à l'installation, au confort et à l'entretien du masque sont notés de 1 (très mauvais) à 10 (très satisfaisant).

Synthèse des avis

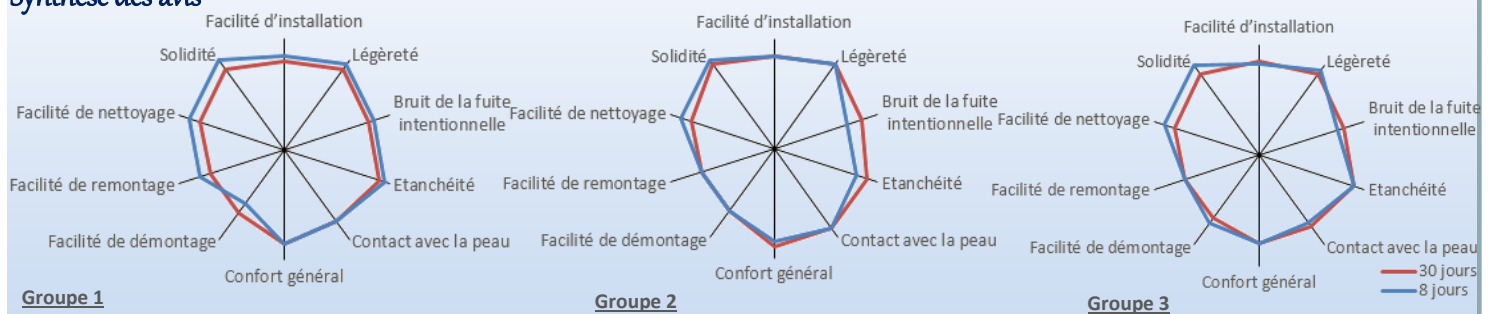

Dans les 3 groupes de patients, il ressort une très bonne appréciation générale du masque suivant les différents critères. La solidité et la légèreté du masque sont des points forts alors que la difficulté de démontage et remontage du masque est signalée comme point plus faible. On note qu'un patient a souhaité arrêter l'essai avant les 30 jours.

Avis CMTS : Pour les masques neufs testés, la courbe pression/débit est « dans la norme ». Au cours de l'évaluation patient, dans les 3 groupes, il ressort une très bonne appréciation générale du masque suivant les différents critères. Sa légèreté et sa solidité sont des points forts. La difficulté de démontage et remontage du masque peut être considérée comme un point plus faible.

« Ce document est la propriété intellectuelle de l'Antadir qui en est l'auteur : toute reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement préalable de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (Article L122-4 du Code de la Propriété intellectuelle)